

IS TRUZZIONI



Accessori

- Apparecchio con astuccio e cinghia da collo
- Cintura toracica e addominale regolabile (lunga) con due sensori integrati per il torace e un sensore addominale
- Sensore di saturazione di ossigeno con cavo di collegamento inserito e cinturino in velcro (corto) per il fissaggio al polso
- Sensore nasale con cavo di collegamento inserito
- Formulario di richiesta, diario del paziente e istruzioni
- Clip di chiusura rosso per la rispedizione

Rispedizione

A termine della registrazione la preghiamo di volerci rispedire l'apparecchio con cavi inseriti, cinghie, velcro, sensore toracico e addominale, sensore della saturazione di ossigeno, formulario di richiesta e diario del paziente. Le spese di spedizione sono a carico di Violier.

- Tramite Servizio clientela – consegna allo studio medico
- Tramite DPD – consegna presso un Pickup parcelshop
→ dpdgroup.com/ch/mydpd/parcel-shops
- Per posta

Per la spedizione della valigetta voglia:

- Rimuovere l'etichetta dal campo visivo
- Far scorrere l'etichetta di restituzione appropriata (nella custodia) nel campo visivo
→ **Indirizzo Violier AG comp**
- Chiudere la valigetta con clip di chiusura rossa



Informazioni importanti






Non avviare l'apparecchio a titolo di prova. L'apparecchio non può più essere spento.

- Prima dell'esame rimuovere lo smalto, le unghie in gel o le applicazioni sulle unghie.
 - Non applicare il sensore della saturazione di ossigeno alla stessa estremità alla quale è applicato il manicotto dell'apparecchio di misurazione della pressione arteriosa delle 24h nel caso di un utilizzo contemporaneo.
 - Applicare e avviare l'apparecchio prima di coricarsi.
 - Durata della registrazione max. 8 ore, adatto per pazienti a partire da 50 kg.
 - Non utilizzare l'apparecchio vicino a TAC, MRI e apparecchiature radiologiche.
 - Telefoni cellulari, forti fonti elettromagnetiche e termocoperte elettriche possono influenzare la qualità della registrazione.

Applicazione dell'apparecchio

Annullare l'annuncio prima di caricarsi

- Apparecchio, cinghia del torace e cinghia addominale non vanno indossati direttamente sulla pelle.
 - Passare la cinghia da collo unitamente all'apparecchio sopra la testa.

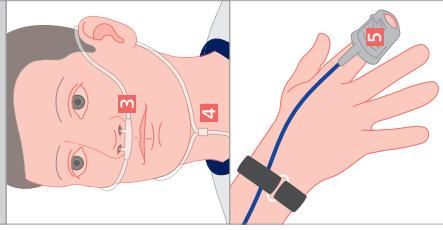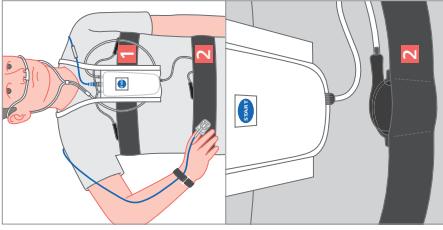

Nulli avviai apprezzino a t'uno ai piova. L'apparecchio non più esseie spento.

- Prima dell'esame rimuovere lo smalto, le unghie in gel o le applicazioni sulle unghie.
 - Non applicare il sensore della saturazione di ossigeno alla stessa estremità alla quale è applicato il manicotto dell'apparecchio di misurazione della pressione arteriosa delle 24h nel caso di un utilizzo contemporaneo.
 - Applicare e avviare l'apparecchio prima di coricarsi.
 - Durata della registrazione max. 8 ore, adatto per pazienti a partire da 50 kg.
 - Non utilizzare l'apparecchio vicino a TAC, MRI e apparecchiature radiologiche.
 - Telefoni cellulari, forti fonti elettromagnetiche e termocoperte elettriche possono influenzare la qualità della registrazione.


Diario del paziente

Informi il paziente sull'importanza diagnostica di compilare correttamente e completamente il diario del paziente.

Si prevede di utilizzare una nenna a sfera

BIOCHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF POLY(2-ALKYL-1,3-PHENYLICARBOXYLIC ACID)

Annotare l'inizio e la fine della registrazione con data e ora.

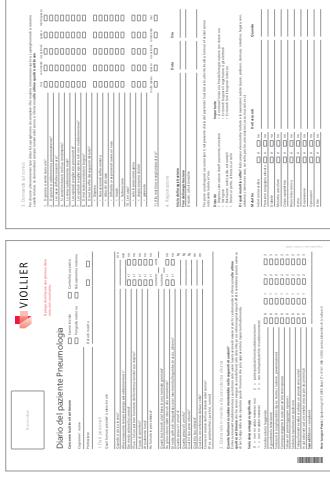

Identificazione e analisi

- Generalità del paziente
 - La data da lei riportata e l'esatta ora d'inizio della registrazione
 - Il numero d'apparecchio e di sensore dato indicato da Viollier nel formulario di richiesta

No anno esecutivo 010 No sensore digitale 015

卷之三

Voglia utilizzare esclusivamente l' allegato
formulario di richiesta già provvisto del suo
indirizzo

- Fissare con il vellcro il sensore
- Nel caso il sensore debba durare la notte, si può

- Avvia l'apparecchio
 - Tenere premuto il **tasto start anteriore blu** **6** per 3 secondi.
 - Durante la registrazione, la **luce verde** **7** lampeggia a intervalli di 4 secondi. Se accanto appare una **luce rossa** **8**, il sensore del dito non è applicato correttamente → voglia per favore correggere.
 - Nel caso il sensore da dito / sensore nasale dovesse staccarsi durante la notte si prega di anniliccare nuovamente

→ La mattina smontare l'apparecchio e rispedirlo.
L'apparecchio si spegne automaticamente dopo 8 ore.