

Accessori

- Apparecchio con 4 cavi
- Elettrodi autoadesivi
- Formulario di richiesta, diario del paziente e istruzioni
- Clip di chiusura rossa per la rispedizione

Rispedizione

A termine della registrazione la preghiamo di volerci rispedire apparecchio, formulario di richiesta e diario del paziente. Le spese di spedizione sono a carico di Viollier.

- Tramite Servizio clientela – consegna allo studio medico
- Tramite DPD – consegna presso un Pickup parcelshop → dpdgroup.com/ch/mydpd/parcel-shops
- Per posta

Per la rispedizione della valigetta voglia:

- Rimuovere l'etichetta dal campo visivo
- Far scorrere l'etichetta di reso corrispondente (nella custodia) nel campo visivo
→ l'indirizzo **Viollier AG compare**
- Chiudere la valigetta con clip di chiusura rossa



ECG delle 24h

Informazioni importanti

La registrazione inizia entro 60 secondi dal contatto degli elettrodi con la pelle.

- Adatto per pazienti a partire da 10 kg
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a TAC, MRI e apparecchiature radiologiche.
- Telefoni cellulari, forti fonti elettromagnetiche e termocoperte elettriche possono influenzare la qualità della registrazione.
- È vietato indossare l'apparecchio in piscina, sauna, vasca da bagno, doccia o in altri ambienti umidi.

Diario del paziente

Si prega di informare il paziente sull'importanza diagnostica di compilare correttamente e completamente il diario del paziente.

- Si prega di utilizzare una penna a sfera nera.
- Annotare l'inizio e la fine della registrazione con data e ora.
- Indicare la data e l'ora di disturbi, attività straordinarie, assunzione di farmaci e fasi del sonno.

Identificazione e analisi

- Generalità del paziente
- La data e l'ora esatta d'inizio della registrazione da lei riportate
- Il numero d'apparecchio indicato da Violier nel formulario di richiesta

No. apparecchio	006	No. manicotto		No. sensore distale	
No. chip		No. batteria			


Voglia utilizzare esclusivamente l'allegato formulario di richiesta già provvisto del suo indirizzo.

Applicazione dell'apparecchio

Preparazione

- Sgrassare la pelle con etanolo 70% e rasare i peli per garantire la perfetta aderenza degli elettrodi.
- Collegare gli elettrodi alle estremità del cavo.
- Collegare un elettrodo adesivo monouso al contatto del pulsante a pressione sul retro del dispositivo. **Si prega di non utilizzare cerotti o nastro adesivo aggiuntivi.**

L'elettrodo viene utilizzato per fissare l'apparecchio al torace del paziente. Questo riduce gli artefatti da movimento e migliora la qualità della registrazione. Questo elettrodo non ha alcuna funzione medica / diagnostica.

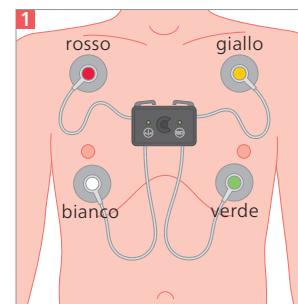

Applicare l'apparecchio

- Posizionare gli elettrodi autoadesivi come da illustrazione 1 al torace del paziente:
 - rosso ● giallo ● verde ○ bianco
- Premere con forza il bordo dell'elettrodo contro la pelle per fissarlo.
- L'apparecchio si avvia automaticamente entro 60 secondi dal contatto degli elettrodi con la pelle.



Controllo della modalità di registrazione

- Il simbolo del 'complesso QRS' 2 indica lo stato di registrazione.
 - Il simbolo 'Batteria' 3 fornisce informazioni sullo stato di carica.
- Luce verde lampeggiante:** registrazione ECG attiva
- Luce verde lampeggiante:** tensione della batteria sufficiente

Battendo con forza con il palmo della mano sull'apparecchio, il paziente può generare un segnale in caso di disagio